


# 「GPS放射線モニタリング」プロジェクト結果

( 1 / 2 )

測定区分	線量率「GPS放射線モニタリング」プロジェクト	測定日	平成24年3月11日(日)
測定地区	文化財指定庭園 特別名勝「兼六園」	測定時間	11:58~16:52
測定点	地上約1m	測定者	橋本重治
測定器	Polimaster PM-1610	記録作成	橋本重治
※Polimaster PM-1610は、(株)ホト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。			

powered by [xls-hashimoto](#)

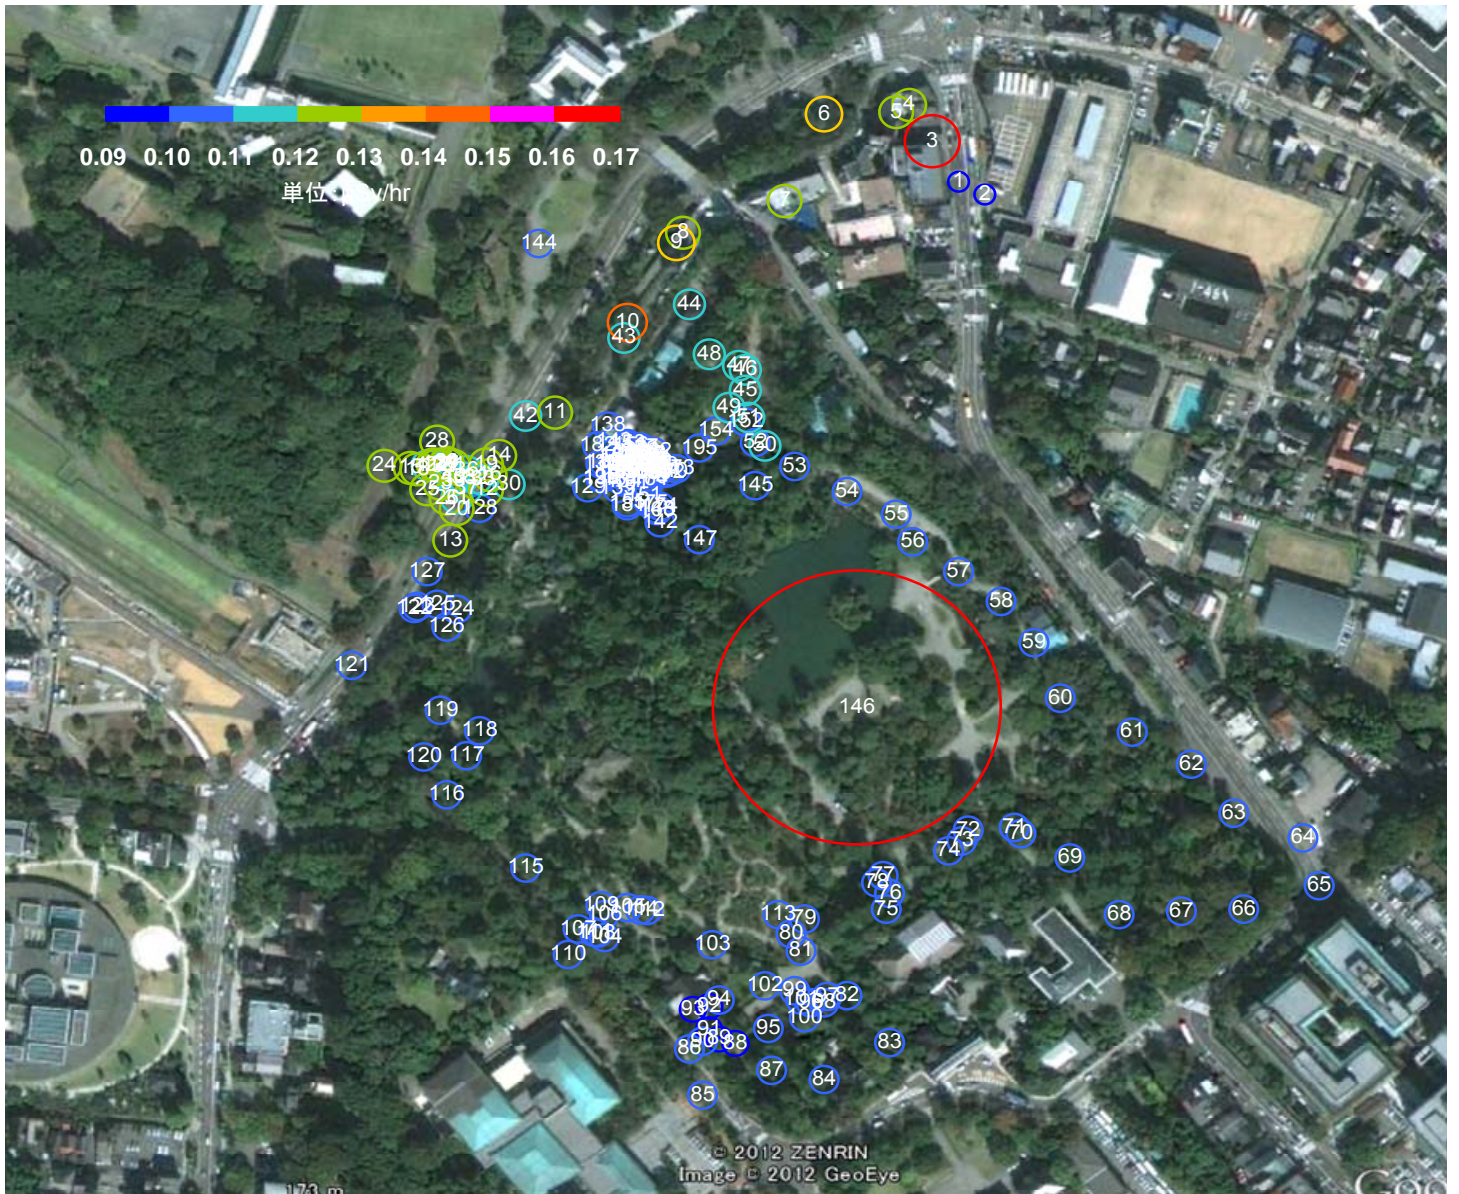

幾何平均線量率		No.1~No.270		0.11 x ÷ 1.18		No.1~No.200		0.11 x ÷ 1.20		単位: μSv/hr									
No	線量率	No	線量率	No	線量率	No	線量率	No	線量率	No	線量率								
1	0.08	21	0.13	41	0.12	61	0.11	81	0.11	101	0.11	121	0.11	141	0.11	161	0.11	181	0.11
2	0.08	22	0.13	42	0.12	62	0.11	82	0.11	102	0.11	122	0.11	142	0.11	162	0.11	182	0.11
3	0.21	23	0.13	43	0.12	63	0.11	83	0.11	103	0.11	123	0.11	143	0.11	163	0.11	183	0.11
4	0.13	24	0.13	44	0.12	64	0.11	84	0.11	104	0.11	124	0.11	144	0.11	164	0.11	184	0.11
5	0.13	25	0.13	45	0.12	65	0.11	85	0.11	105	0.11	125	0.11	145	0.11	165	0.11	185	0.11
6	0.14	26	0.13	46	0.12	66	0.11	86	0.11	106	0.11	126	0.11	146	1.10	166	0.11	186	0.11
7	0.13	27	0.13	47	0.12	67	0.11	87	0.11	107	0.11	127	0.11	147	0.11	167	0.11	187	0.11
8	0.13	28	0.13	48	0.12	68	0.11	88	0.10	108	0.11	128	0.11	148	0.11	168	0.11	188	0.11
9	0.14	29	0.13	49	0.12	69	0.11	89	0.10	109	0.11	129	0.11	149	0.11	169	0.11	189	0.11
10	0.15	30	0.12	50	0.12	70	0.11	90	0.11	110	0.11	130	0.11	150	0.11	170	0.11	190	0.11
11	0.13	31	0.12	51	0.12	71	0.11	91	0.10	111	0.11	131	0.11	151	0.11	171	0.11	191	0.11
12	0.13	32	0.12	52	0.11	72	0.11	92	0.10	112	0.11	132	0.11	152	0.11	172	0.11	192	0.11
13	0.13	33	0.12	53	0.11	73	0.11	93	0.10	113	0.11	133	0.11	153	0.11	173	0.11	193	0.11
14	0.13	34	0.12	54	0.11	74	0.11	94	0.11	114	0.11	134	0.11	154	0.11	174	0.11	194	0.11
15	0.13	35	0.12	55	0.11	75	0.11	95	0.11	115	0.11	135	0.11	155	0.11	175	0.11	195	0.11
16	0.13	36	0.12	56	0.11	76	0.11	96	0.11	116	0.11	136	0.11	156	0.11	176	0.11	196	0.11
17	0.13	37	0.12	57	0.11	77	0.11	97	0.11	117	0.11	137	0.11	157	0.11	177	0.11	197	0.11
18	0.13	38	0.12	58	0.11	78	0.11	98	0.11	118	0.11	138	0.11	158	0.11	178	0.11	198	0.11
19	0.13	39	0.12	59	0.11	79	0.11	99	0.11	119	0.11	139	0.11	159	0.11	179	0.11	199	0.11
20	0.13	40	0.12	60	0.11	80	0.11	100	0.11	120	0.11	140	0.11	160	0.11	180	0.11	200	0.11

コメント  
No.3からしばらくは、測定開始直後の誤差が大きいデータ  
No.146は手修正した架空のデータ

